M2720A Avalon CTS Bezdrátový systém snímání plodu

Výstrahy a činnost uživatele

Výstrahy základnové stanice:

bliká, samostatně nebo s kontrolkami nalevo nebo napravo. označuje, že kontrolka nesvítí nebo svítí nepřetržitě.

označuje akustické upozornění, je-li nastaveno. Stiskněte C pro vypnutí zvukové indikace.

Výstrahy snímače:

bliká společně se symbolem představujícím zdroj problému.

Bude-li generována tato výstraha…		…Proveďte toto…
…Na základnové stanici…	…Na snímači…	
		Vložte snímač pro dobíjení akumulátoru nebo použijte jiný snímač s nabitým akumulátorem. Pokud 30 minut po výměně problém stále přetrvává, vyměňte akumulátor snímače. (Viz *servisní příručka*.)
		
		Zkontrolujte, zda je snímač aktivní a nachází se v dosahu příjmu. Zkontrolujte připojení antény.
		Stiskněte C po dobu dvou sekund pro odblokování slotu.
Příklad označení lůžka		Tento slot již má **aktivní** snímač (v tomto příkladě je označení lůžka 38). *Buď* vložte nejdříve tento snímač, aby byl slot dostupný *Nebo*, je-li na snímači zobrazeno označení lůžka (v tomto příkladě 16), vraťte jej do jeho základnové stanice.
Příklad označení lůžka	Příklad označení lůžka	
		Obraťte se na poskytovatele servisních služeb (snímač se nemůže zaregistrovat).
		Je-li aktivní snímač EKG, připojte kabel. Vložte snímač do slotu dle pozice indikované bodem (snímač je v nesprávném slotu).
Chybové zprávy základnové stanice a snímačů (E0 až E9): Viz ***návod k obsluze*.**		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
Vytištěno v Německu, duben 2006
Číslo M2720-9049B
4512 610 15061

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Německo

PHILIPS

M2720A Avalon CTS Bezdrátový systém snímání plodu
Stručné pokyny

1 110 – 240 V stř.



2 Zapněte

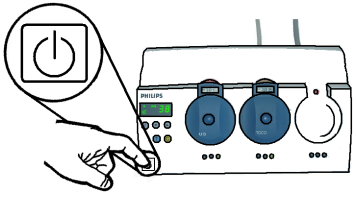

3

TELE

Zkontrolujte, zda se na fetálním monitoru zobrazilo “TELE” indikující dobré spojení se systémem Avalon CTS

4 Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka „připraveno“



5 Vyjměte snímač



Kontrolka „připraveno“ zhasne: rozsvítí se kontrolka „vysokofrekv. spojení“



6 Aplikujte snímač (pro ultrazvukový snímač použijte gel)

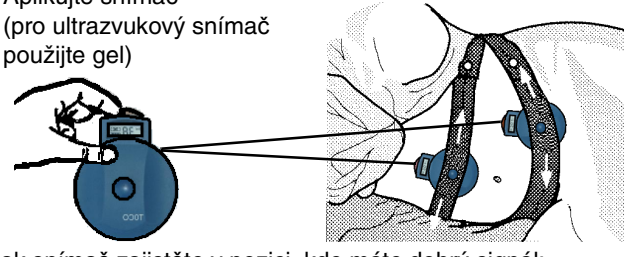

Pak snímač zajistěte v pozici, kde máte dobrý signál:

monitory Avalon

monitory série 50

Přechod od ultrazvuku k monitorování DECG	
1	Zapojte (vložte) ultrazvukový snímač.
2	Vyjměte snímač EKG, když bude kontrolka daného slotu svítit zeleně.
3	Připojte přechodový kabel DECG a skalpovou elektrodu ke snímači EKG.
4	Zahajte monitorování DECG.

Přechod od DECG k monitorování ultrazvukem	
1	Odpojte přechodový kabel DECG a skalpovou elektrodu od snímače EKG.
2	Zapojte (vložte) snímač EKG.
3	Vyjměte ultrazvukový snímač, když bude kontrolka daného slotu svítit zeleně.
4	Zahajte monitorování ultrazvukem.

Před použitím systému Avalon CTS odpojte od monitoru všechny kabelově připojené elektrody.

Dva aktivní snímače vysílající srdeční frekvenci plodu do stejné základnové stanice zaviní výskyt chybové zprávy **E9**.
Pro vymazání této zprávy vložte jeden ze snímačů do slotu.

Po použití: Očistěte snímače. Pak je vložte do příslušných slotů základnové stanice.